

**DILIGÊNCIA**

3 mensagens

Santana do Cariri <licitasantana2021@gmail.com>
Para: Alves Consultoria <alvesconsultoria2020@gmail.com>

29 de setembro de 2022 15:06

Prezado, boa tarde, solicitamos a Empresa MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L, resposta no prazo máximo de **01 (Um dia) útil, ou seja, até o dia 03/10/2022**, quanto ao questionamento pela empresa BIOCORE COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSP E LABORATO, que segue anexo. Processo de pregão eletrônico nº29.08.2022.01-SRPE, cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual aquisição de fórmula para nutrição enteral visando atender as demandas da secretaria de saúde do município de Santana do Cariri-Ce, realizado através da plataforma do Banco do Brasil, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.

Atenciosamente,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SANTANA DO CARIRI-CE **PM Cariri - Argumentação.pdf**
275K

Alves Consultoria <alvesconsultoria2020@gmail.com>
Para: Santana do Cariri <licitasantana2021@gmail.com>
Cc: André Bindá <andre@medicalcenterce.com.br>, Fayad <fayad@medicalcenterce.com.br>

3 de outubro de 2022 16:20

Prezados, boa tarde.

Segue em anexo resposta ao pedido de diligência promovido mediante aos questionamentos da empresa Biocore.

Favor acusar recebimento.

Atenciosamente,

ISAAC ALVES
ANALISTA DE LICITAÇÕES

✉ ALVESCONSULTORIA2020@GMAIL.COM
☎ (85) 99174-3640
☎ (85) 99150-2026

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Resposta aos questionamentos do PE29.08.202201 da PM de Santana do Cariri II.pdf
214K

Santana do Cariri <licitasantana2021@gmail.com>
Para: Alves Consultoria <alvesconsultoria2020@gmail.com>

4 de outubro de 2022 08:26

acusamos o recebimento!



Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri-CE
PREGAO ELETRONICO N° 29.08.2022.01-SRPE

DILIGÊNCIA

REF.: RESPOSTA AS ARGUMENTAÇÕES DA EMPRESA BIOCORE COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSP E LABORATO, REFERENTE AOS ITENS COTADOS E ARREMATADOS PELA MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO PE 29.08.2022.01 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI-CE, ENVIADAS DIA 29 DE SETEMBRO DE 2022.

A empresa MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi declarada vencedora, após a fase de lances, nos itens 01 e 02 do pregão 29.08.2022.01-SRPE. No entanto, a empresa BIOCORE COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSP E LABORATO questionou, mais uma vez, a impossibilidade de uso, das referidas dietas vencedoras, **Fresubin HP Energy 1L e Fresubin 1.2 HP Fibre 1L (marca Fresenius-kabi)**, como **sistema aberto** e que **nossas dietas agregariam "custo elevado para a família"**. Fatos estes já respondidos e acatados por esta douta instituição.

Ainda, a empresa BIOCORE, questionou o perfil lipídico das dietas da Fresenius que foram vencedoras no referido certame, afirmando que o **Fresubin HP Energy 1L possui 35% de lipídios, enquanto o edital solicita 25%**.

Quanto ao primeiro questionamento, é importante ressaltar aqui que as dietas em sistema EasyBag da Fresenius-kabi podem sim ser usadas como sistema aberto, através um dispositivo prático e que possibilita o uso fracionamento da dieta. O **FRACIONADOR** de dieta possibilita o envase em frasco adequado para administração **COMPATÍVEL COM SISTEMA ABERTO**. Ressalta-se que a utilização do **FRACIONADOR** de Jieta **não acarreta nenhum tipo de prejuízo, riscos, ou perdas de produtos para o usuário**, sejam estes de natureza econômica, microbiológica/controla de qualidade ou durante o manuseio.

O **Fracionador de EasyBag** é uma tecnologia especialmente desenvolvida para facilitar a retirada da dieta enteral do sistema Easybag e, assim, realizar o porcionamento em frascos de acordo com a prescrição do médico e/ou nutricionista. É uma tecnologia que possui **registro na ANVISA (N°80305560062)**, **possuindo regulamentação e autorização para ser usado, com praticidade e segurança, na transformação do sistema fechado em sistema aberto**. O dispositivo Fracionador de EasyBag é embalado em papel grau cirúrgico, estéril, unitário, com ponta EN Plus exclusiva para Nutrição Enteral, com tampas protetoras nas duas extremidades. A sugestão de uso é de 01 unidade/dia, considerando a higienização do dispositivo a cada fracionamento de dieta e não acarretará nenhum custo a mais para esta douta instituição.

Após as argumentações realizadas acima podemos afirmar que as dietas **Fresubin HP Energy 1L** e **Fresubin 1.2 HP Fibre 1L (marca Fresenius-kabi)** podem ser utilizadas como **sistema aberto**, através do uso do **fracionador**; sua embalagem **Easybag tem sustentabilidade vertical** que **evita desperdício** (como observado nas figuras acima); e traz maior segurança ao paciente, pois, sua membrana auto cicatrizante evita o contato direto da dieta com o ar.

Referente ao segundo questionamento da empresa BIOCORE, referente ao **perfil lipídico**, nos espanta tal argumentação, pois, a dieta oferecida na **proposta da empresa Biocore**, que está em **3º lugar** no referido item, foi o **Trophic EP 1L (marca Prodiet)** e possui **30% do Valor Calórico Total (VCT) na forma de lipídios**. Levando em consideração a própria declaração da referida empresa, ela estaria fora da especificação do item 01 quanto ao percentual de lipídios, que solicita **25%**.

No entanto, não estamos aqui para questionar isso, pois, entendemos que os descritivos, tanto do item 1 quanto do item 2, solicitam dietas enterais que estão dentro das necessidades específica de cada paciente e que atendem a **Resolução da Diretoria Colegiada N°21 de 13 de maio de 2015, que dispõe sobre o regulamento técnico de fórmulas para nutrição enteral**. Segundo essa RDC, uma dieta enteral pode ser considerada **normolipídica** quando a quantidade de lipídios é **maior ou igual a 15% e menor ou igual a 35% do VCT**.

Assim, levando em consideração o descritivo do item 01, podemos observar que este solicita uma dieta **polimérica, hipercalórica, hiperproteica, nutricionalmente completa**; com fonte de lipídios de **25% do VCT**. o **Fresubin HP Energy 1L (marca Fresenius-kabi)** é uma dieta **hipercalórica, hiperproteica** e está **dentro do intervalo de uma dieta normolipídica** segundo **regulamento técnico da RDC 21 de 2015** exige.

Nesse contexto, mais uma vez a empresa Biocore se manifesta de maneira equivocada ao afirmar tais inverdades, já que as informações repassadas não são corretas. Sendo importante ressaltar mais uma vez que a tecnologia utilizada nas embalagens Easybag das dietas enterais da Fresenius-Kabi **está em conformidade com as resoluções da ANVISA**, tanto no uso do **fracionador** quanto em sua fonte de lipídios.

Além de garantir a segurança e praticidade, o sistema Easybag possui uma **membrana auto cicatrizante** que mantém o sistema fechado após a retirada do Fracionador. Isso garante a **esterilidade** e mantém a segurança após aberto. Além disso, **após aberto o sistema pode ser utilizado em um prazo de 24h.**


Abaixo seguem informações do **FRACIONADOR** que será ofertado sob forma de bonificação para cada litro de dieta solicitada pela instituição. Também, estamos enviando um vídeo institucional desenvolvido pela Fresenius-kabi que demonstra o passo a passo referente ao uso do fracionador e a transformação em sistema aberto.



- INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: DISPOSITIVO FRACIONADOR DE EASYBAG

1. Agite o EasyBag.
2. Remova o lacre do EasyBag.
3. Abra a embalagem do **Fracionador** do EasyBag e remova a tampa protetora do dispositivo.
4. **Conecte o Fracionador** ao EasyBag, tomando o cuidado de rosquear completamente o dispositivo no orifício (acesso) do EasyBag.
5. Posicione cuidadosamente o fracionador, já conectado ao EasyBag, dentro do orifício de entrada do frasco de dieta.
6. Coloque a quantidade de dieta desejada/prescrita para este horário de administração de dieta.
7. Coloque a tampa no frasco de dieta e siga com a administração conforme orientação de seu Nutricionista.
8. **Remova o dispositivo Fracionador**, tomando o cuidado de desrosquear completamente do orifício do EasyBag. **IMPORTANTE:** o fracionador deve ser removido do EasyBag a cada término de envase da dieta. Desta forma a membrana auto cicatrizante presente no orifício de conexão do EasyBag se fechará, impedindo o vazamento da dieta ou entrada de ar no interior da embalagem.
9. Imediatamente lave o Dispositivo em água corrente potável ou filtrada, evitando que fique resíduos de dieta no interior do dispositivo. Coloque as tampas protetoras nas duas extremidades e guarde o dispositivo em local seguro.
10. Armazenamento do EasyBag com o uso do fracionador: após a 1ª conexão do fracionador no orifício do EasyBag, temos 24h para administrar todo o conteúdo da dieta.

ILUSTRAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO FRACIONADOR + DIETA ENTERAL EM SISTEMA FECHADO EASYBAG + FRASCO PARA DIETA ENTERAL

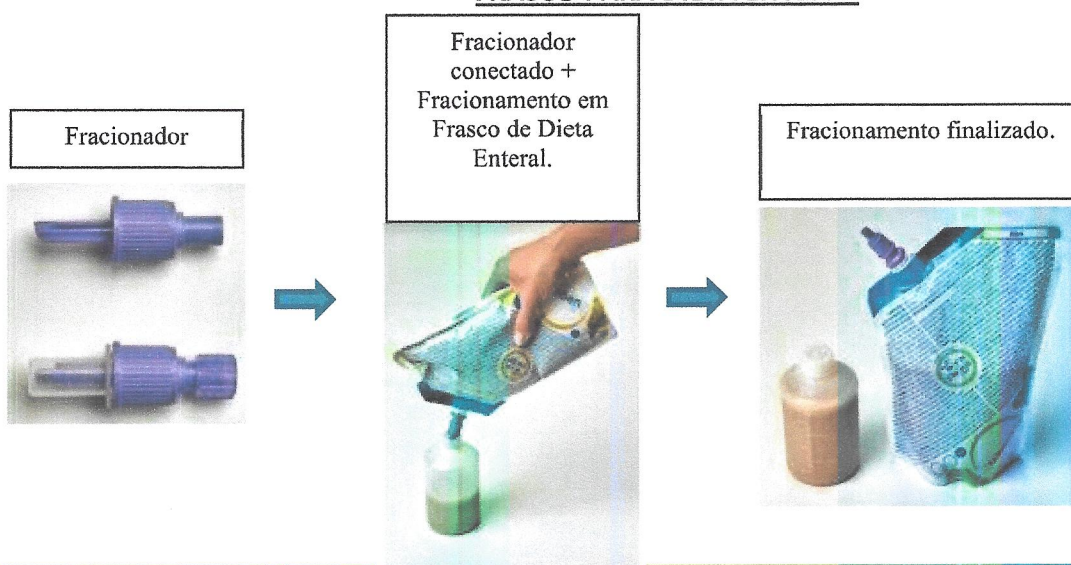

Por fim, ressaltamos que estamos à disposição dessa douda instituição quanto ao suporte técnico e quaisquer esclarecimentos necessários quanto ao uso das dietas enterais com sistema Easybag da Fresenius-kabi.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Lauro de Freitas/BA, 03 de outubro de 2022



RAIMUNDO JOSE MOREIRA
SANTOS:22986251587

Assinado digitalmente por RAIMUNDO JOSE MOREIRA
SANTOS:22986251587
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26199364000173, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=RAIMUNDO JOSE MOREIRA SANTOS:22986251587
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.10.03 16:18:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

RAIMUNDO JOSÉ MOREIRA SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 2364962-39 - SSP/BA
MEDICAL CENTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
CNPJ 07.032.320/0001-72